



Szamotuły, 21 października 2021 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w procedurze podstawowej bez negocjacji, pn.: **Dostawa sterylnego, specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku (ZP-381-43/2021)**

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w **Zadaniu 9** w pozycji **9** dopuści (stosowaną dotychczas przez Zamawiającego) prowadnicę do rurek o średnicy 8,5 – 11 mm; spełniającą pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w **Zadaniu 9** w pozycjach **13 i 14** dopuści (stosowany dotychczas przez Zamawiającego) system z kranikiem spustowym (bez odpowietrznika); spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiającym w **Zadaniu 9** w pozycji **17** dopuści (z racji na zmianę dokonaną przez producenta) zestaw ze strzykawką luer lock **30 ml**; spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 4

Czy mogę uzyskać informację o próbkach do postępowania nr ZP-381-43/2021 (zgodnie z pkt. 7 SWZ) Do których pakietów i jakie ilości należy złożyć.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje dostarczenia 1 niedopłatanej próbki asortymentu będącego przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie różnych rozmiarów, dla Zamawiającego wystarczającym będzie dostarczenie dowolnie wybranego rozmiaru oferowanego przedmiotu zamówienia. Dostarczone próbki mogą być produktem niesterylnym.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 1 Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 1,2,3,4,5,6 i dopuści w

Poz. 1 Klipsownica jednorazowego użytku, z możliwością otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, rozwarcie klipsa 11 i 16 mm, kąt rozwarcie 135*, długość robocza narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,5 mm.

Poz. 2 Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyzeczki owalne z okienkiem, z kolcem. Śr. osłonki 2,3 mm. Dł. narzędzia 180 cm i 230 cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem. Możliwość otwierania i zamykania łyżeczek bez względu na stopień podgięcia endoskopu. Min. śr. kanału roboczego 2,8 mm.

Poz. 3 Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyzeczki typu aligator z kolcem. Śr. cewnika 2,3 mm. Dł. narzędzia 230 cm. Spiralny cewnik pokryty teflonem. Na opakowaniu min. 3 etykiety samoprzylepne z kodem.

Poz. 4 Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr. ostrza igły 0,7 mm, dł. ostrza 5 mm, dł. narzędzia 230 cm, osłonka śr. 2,3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający

niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem.

Poz. 5 Ustnik endoskopowy jednorazowego użytku, z gumką tekstylną, nie zawierający lateksu.

Poz. 6 Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, płcionka, pętla owalna, śr. pętli 10, 15, 24, 36 mm Śr. Osłonki 2,3 mm. Rękojeść skalowana co 5 mm. Dł. narzędzia 230 cm.

Odpowiedź

Analiza treści pytania wskazuje, że nie dotyczy ona pakietu nr 1. Zamawiający przypuszcza, że pytanie dotyczy pakietu nr 5. Zamawiający nie wyłącza do osobnego zadania z pakietu nr 5 pozycji 1,2,3,4,5,6. Pomimo braku zgody na wyłączenie wskazanych pozycji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6

Zadanie nr 5 poz 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie klipsownic o szerokości rozwarcia ramion klipsa 12 i 16mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 7

Zadanie nr 5 poz 2;3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kleszczyków pokrytych z osłonką PE, bezpieczną dla kanałów endoskopów, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 8

Zadanie nr 5 poz 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igieł o średnicy osłonki 2,4mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 9

Zadanie nr 5 poz 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli o średnicy osłonki 2,4mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 10

Zadanie nr 5 poz 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawów do opaskowania żyłaków 7-gumkowego, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 11

Zadanie nr 5 poz 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pułapek 5-komorowych, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 12

Zadanie nr 5 poz 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie chwytaków do polipów o średnicy osłonki 2,4mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 13

Zadanie nr 5 poz 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie chwytaków do polipów o wymiarach 30x55mm lub 40x60mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 14

Zadanie nr 5 poz 14-16

Prosimy o wydzielenie zaworów z możliwością sterylizowania z pakietu produktów jednorazowego użytku, w ten sposób Zamawiający poprawi konkurencyjność składanych ofert. Należy zaznaczyć, że asortyment ten jest sukcesywnie wycofywany przez producentów z ich ofert.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu pozycji, o których mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 15

Zadanie nr 5 poz 14-16

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaworów jednorazowego.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 16

Zadanie nr 5 poz 17

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przewodu o długości 120cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 17

Zadanie nr 5 poz 18

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie żelu w tubie 200ml, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 18

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 38 z pakietu 14 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wdzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu pozycji, o których mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 19

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 54 i 55 z pakietu 14 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu pozycji, o których mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 20

Pakiet nr 5 Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsów o szerokości rozwarcia 12 mm i 15 mm, średnica cewnika 2,6 mm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 21

Pakiet nr 5 Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 22

Pakiet nr 5 Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o długości ostrza 6 mm.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 23

Pakiet nr 5 Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10, 15, 25 i 32 mm, średnica osłonki 2,4 mm, długość osłonki 240 cm, rękojeść skalowana co 10 mm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 24

Pakiet nr 5 Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10 mm.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 25

Pakiet nr 5 Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie zestawu szczotek ze szczotką do czyszczenia kanałów roboczych o długości 250 cm i szczotką czyszczenia gniazd endoskopów o średnicy 5 mm i 10 mm.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 26

Pakiet nr 5 Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie chwytaka rozpostartego na pętli o średnicy 40 mm.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 27

Pakiet nr 5 Czy Zamawiający w pozycji 18 dopuści zaoferowanie żelu w tubie o pojemności 200 ml.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 28

Pakiet nr 5 Czy Zamawiający w pozycji 21 dopuści zaoferowanie majtek w rozmiarze L i XL.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 29

Dotyczy zadania nr 1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy będzie wymagać, aby Wykonawca był uprawniony przez producenta do dystrybucji na terenie Polski, co związane jest z odpowiedzialnością przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych związaną z akcjami korekcyjnymi dotyczącymi incydentów medycznych i potwierdził to odpowiednim dokumentem autoryzacyjnym od producenta oraz dodatkowo załączył dokument w postaci gwarancji wystawionej przez producenta?

Odpowiedź

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawców spełnienia warunków, o których mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 30

Dotyczy zadania nr 1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy będzie wymagać aby termin przydatności do użycia dostarczonych igieł doszpikowych wynosił przynajmniej 48 miesięcy, dzięki czemu w przypadku ich dłuższego przechowywania nie dojdzie do sytuacji kiedy to nieużyte igły utracą ważność – Zamawiający nie zostanie narażony na straty w wyniku zakupu i nieużycia igieł doszpikowych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia miał okres przydatności przynajmniej 48 miesięcy.

Pytanie nr 31

Dotyczy zadania nr 1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy nie doszło do omyłki pisarskiej w opisie przedmiotu zamówienia? System wkłuć, który opisuje Zamawiający ma podział w zakresie : pediatrycznym – 0-12 lat; dorośli – powyżej 12 lat. W związku z tym prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź

Zabawiający doprecyzowuje opis przedmiotu w zakresie zadania nr 1. Rozmiar pediatryczny w zakresie – 0-12 lat, rozmiar dla dorosłych w zakresie powyżej 12 lat.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 6 do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi o średnicy 11 Fr i 13Fr i długościach: 15 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 7 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długościach: 19/40 cm, 23/49 cm, 28/49 cm, 33/54 cm wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 34

Pytanie dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert wydzieli z pakietu pozycje nr 14, 15, 16, 17 oraz 19 i utworzy z nich oddzielne zadanie?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu pozycji, o których mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 35

Pakiet nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przetworników o długości 180+30cm lub 130+30cm lub 120+30?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę za zaoferowanie przetworników o długości 180+30cm lub 130+30cm.

Pytanie nr 36

Pakiet nr 8

Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?




Odpowiedź

Zamawiający informuje, że przetwornik łączy się z kablem monitora końcówką Abbott.

Pytanie nr 37

Pakiet nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przetworników do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z poniższym schematem?

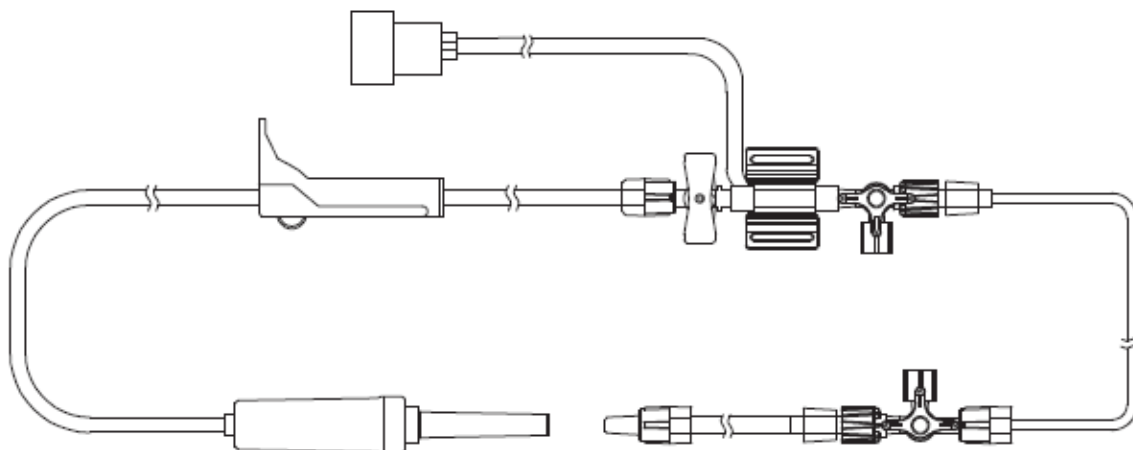

Odpowiedź

Zamawiający w swoich wymaganiach nie określił szczegółowego schematu dotyczącego zaoferowanych przetworników do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną. Przedstawiony w

zapytaniu schemat pozbawiony jest szczegółowego opisu, co uniemożliwia odpowiedź na zadanie pytanie.

Pytanie nr 38 – dotyczy pakietu 8

Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta; linia do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedyncza, zawierająca podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300 mmHg, szybkie płukanie z szybkością >70 ml/h. Częstotliwość własna przetwornika >200 Hz. Linie ciśnieniowe grubościennne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 39– dotyczy pakietu 12 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski anestetycznej z nadmuchanym miękkim mankietem w rozmiarach 0-6, bez regulacji ciśnienia w mankiecie, z kodowanym kolorystycznie pierścieniem mocującym, nie zawierającą lateksu i szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 40– dotyczy pakietu 12 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodu oddechowego jednorazowego użytku o gładkim świetle wewnątrz, z łącznikiem Y zakończonym kapturkiem zabezpieczającym, o długości 200 cm mikrobiologicznie czystego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 41– dotyczy pakietu 12 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodu oddechowego jednorazowego użytku o gładkim świetle wewnątrz, z łącznikiem Y z dwoma portami 7.6mm zabezpieczonymi koreczkami, o długości 1,6 m, układ zakończony kapturkiem zabezpieczającym, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 42– dotyczy pakietu 12 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodu oddechowego jednorazowego użytku typu rura w rurze o długości 1,8 m i średnicy 22 mm, z łącznikiem kolankowym, z dodatkową krótką rurą i testerem szczelności pozwalającym zweryfikować integralność wewnętrznej przegrody i zapobiegającemu przypadkowemu mieszanemu się gazów wdechowych i wydechowych, mikrobiologicznie czystego?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 43– dotyczy pakietu 12 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodu oddechowego jednorazowego użytku, o średnicy 22mm, dwie rury o regulowanej długości w zakresie 40-200 cm z dodatkową rurą do worka o długości 1,5 m po rozciągnięciu, z łącznikiem Y i łącznikiem kolankowym z portem luer lock, z workiem neoprenowym bezlateksowym o pojemności 2L z pętelką do odwieszania, układ mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 44– dotyczy pakietu 12 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łyżek do laryngoskopu światłowodowego, wykonanych ze sztywnego plastiku, matowych w kolorze szarym, nieprzezroczystych, wykonanych z ABS, do MRI, kompatybilnych z uchwytami zgodnymi z ISO 7376/3, z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru łyżki, zgodne z ISO, pojedynczo pakowanych w opakowanie folia-papier, z symbolem jednorazowego użytku na łyżce, mikrobiologicznie czystych?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 45– dotyczy pakietu 12 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski tlenowej do wysokich stężeń dla dorosłych z rezerwuarem wykonaną z miękkiego, plastycznego polipropylenu – całkowicie pozbawioną PVC, z elastomerowym, bezciśnieniowym, termoplastycznym mankietem uszczelniającym z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmującym twarz z brodą, nie wymagającej zastosowania blaszki w okolicy nosa, ze standardowymi łączami i drenem o przekroju gwiazdki nie załamującym się, o długości 2,1 m?

Odpowiedź

Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji nr 6 zadania nr 12.

Pytanie nr 46

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zad. 3 poz. 3? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej jakościowo oraz cenowo oferty?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu pozycji, o której mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 47

Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad. 3, poz.1, na zestaw do drenażu klatki piersiowej Pluer-evac znanego amerykańskiego producenta, posiadający komorę zbior. 2,5 l. ze skalą pediatriczną od 0 do 100 ml co 1 ml, od 100 do 200 co 2 ml, wydzieloną komorą zastawki podwodnej, wydzieloną mechaniczną komorą regulacji podciśnienia, z możliwością nastawienia

siły ssania w zakresie od 10 do 40 mm H₂O za pomocą mechanicznego pokrętła; możliwością regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu; automatyczną zastawką zabezpieczającą przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim; automatycznym odbarczaniem wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną (dzięki zastosowaniu automatycznych zastawek, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej komory manometrycznej do monitorowania ciśnienia gdyż jest ono regulowane w pełni automatycznie i w tej sytuacji zestaw jest zestawem konstrukcyjnie 4 komorowym); port bezigłowy do komory zastawki podwodnej, drugi port bezigłowy na drenie do pobierania próbek; optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania; komorami zawierającymi barwnik umożliwiające łatwy odczyt poziomów płynów; wyposażony w przycisk do wyrównania ciśnienia z filtrem przeciwwskażeńiowym; wyposażony w miernik przecieku doopłucnowego; drenaż pracujący bezgłośnie; w całości z półprzezroczystymi z samouszczelniającymi się drenami z antyzłamaniowym zabezpieczeniem z wysuwaną podstawką i haczykami do powieszenia; sterylny pakowany w folię i w podwójny papier?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 48

Pytanie do SWZ (Przedmiotowe Środki Dowodowe), punkt 7 – Prosimy o doprecyzowanie do jakich pakietów oraz pozycji należy dostarczyć próbki?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje dostarczenia 1 niedopłatanej próbki asortymentu będącego przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie różnych rozmiarów, dla Zamawiającego wystarczającym będzie dostarczenie dowolnie wybranego rozmiaru oferowanego przedmiotu zamówienia. Dostarczone próbki mogą być produktem niesterylnym.

Pytanie nr 49

Zadanie nr 5, pozycja nr 5 – Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z zadania nr 5 pozycję 5 do osobnego pakietu i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie

oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu pozycji, o której mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 50

Zadanie nr 11, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści woreczki o pojemności 150ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 51

Zadanie nr 11, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści osłonę o wymiarach 16 x 250 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 52

Zadanie nr 11, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści osłonę o wymiarach 183 x 105 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 53

Zadanie nr 11, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści zestaw o pojemności 20-25ml?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 54

Zadanie nr 11, pozycja nr 9 – Czy zamawiający dopuści pojemnik z zakręcanym zamknięciem?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 55

Zadanie nr 11 , pozycja nr 12 – Czy zamawiający dopuści worek na mocz z jedną ścianką w kolorze białym?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 56

Zadanie nr 14, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 57

Zadanie nr 14, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 58

Zadanie nr 14, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 59

Zadanie nr 14, pozycja nr 19-20 – Czy zamawiający wymaga cewników ze zmrożoną powierzchnią?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 60

Zadanie nr 14, pozycja nr 21 – Czy zamawiający dopuści wąsy tlenowe o długości 2m?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 61

Zadanie nr 14, pozycja nr 24-27 – Czy zamawiający wymaga rurek wykonanych z PCV?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 62

Zadanie nr 14, pozycja nr 28 – Czy zamawiający dopuści dren Kehra o długości 45cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 63

Zadanie nr 14, pozycja nr 35 – Czy zamawiający dopuści komorę kroplową o pojemności 18ml +/- 2ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 64

Zadanie nr 14, pozycja nr 39 – Czy zamawiający dopuści strzykawkę z igłą 0,5x16 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 65

Zadanie nr 14, pozycja nr 62 – Czy zamawiający dopuści igły 1,2x30mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 66

Zadanie nr 16, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:

- zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- zamykany port do podawania leków z końcówką Luer
- przezroczysta komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów

- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 67

Zadanie nr 16, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:

- posiada zintegrowany łącznik o kącie 90° do podłączenia rurki i respiratora
- dodatkowa, obrotowa złączka 15mm
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z połączeniem luer
- posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI)
- posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- samouszczelniająca się zastawka izolująca cewnik od pacjenta

- system wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania
- w zestawie do użytku opcjonalnego przestrzeń martwa, zatyczka portu do leków wziewnych, łącznik
- sterylne, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowana folia/papier
- rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 68

Zadanie nr 16, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:

- zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- zamykany port do podawania leków z końcówką Luer
- przezroczysta komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej

- zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 30 cm (10, 12, 14, 16 FR)?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 69

Zadanie nr 16, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:

- posiada zintegrowany łącznik o kącie 90° do podłączenia rurki i respiratora
- dodatkowa, obrotowa złączka 15mm
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z połączeniem luer

- posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI)
- posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- samouszczelniająca się zastawka izolująca cewnik od pacjenta
- system wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania
- w zestawie do użytku opcjonalnego przestrzeń martwa, zatyczka portu do leków wziewnych, łącznik
- sterylne, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowana folia/papier
- dla rurek tracheostomijnych: dł. 33 cm (10, 12, 14, 16 FR)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 70

Zadanie nr 16, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści dren o średnicy 24CH-25CH?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 71

Zadanie nr 16, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania z dwoma otworami bocznymi, o twardości ok. 75 ShA, bez zintegrowanego pierścienia minimalizującego uszkodzenia błony śluzowej?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 72

Zadanie nr 16, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania z dwoma otworami bocznymi, o twardości ok. 75 ShA, bez zintegrowanego pierścienia minimalizującego uszkodzenia błony śluzowej?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 73

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu pozycji, o której mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 74

Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi korka?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 75

PAKIET 14 POZ. 14-17

Czy zamawiający wydzieli poz.14-17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu pozycji, o których mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 76

PAKIET 14 POZ. 18,35,36

Czy zamawiający wydzieli poz.18,35,36 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu pozycji, o których mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 77

PAKIET 14 POZ. 35

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier – folia, sterylizowany tlenkiem etylenu *objętość komory kroplowej – 12,37 cm³, powierzchnia komory 36,52 cm², powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm² (objętość 3,69 cm³), sterylizacja EO?*

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 78

PAKIET 14 POZ. 40,41,42,46

Czy zamawiający wydzieli poz.18,35,36 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu pozycji, o których mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 79

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:

1. W przypadku zwłoki w terminowym wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 0,1 % wartości netto przedmiotu dostawy za każdy kolejny dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto przedmiotu dostawy.**

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie zaproponowanym w zapytaniu.

Pytanie nr 80

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź

Faktury mogą być wystawiane i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). Ponadto Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy

Pytanie nr 81

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7a projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „... od dnia zgłoszenia wady” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie zaproponowanym w zapytaniu.

Pytanie nr 82

Pakiet 18: Czy Zamawiający wymaga aby wyrób posiadał 4 samoprzylepne etykiety identyfikujące tzw. TAG?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 83

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 18:

taśmę urologiczną do leczenia nietrzymania moczu u kobiet metodą TVT, polipropylenową, monofilamentową, z plastikową osłonką na taśmie, niewchłaniającą, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 80 µm, gramatura 48 g/m², wielkość porów średnia 0,98 mm, max. 2,31 mm wykonaną w technologii quadriaxial (*geometria romboidalna, obecność włókien skośnych zapobiega deformacji w kierunku skośnym, który jest kierunkiem decydującym jeśli chodzi o deformację, podwójna nić wzmacniająca*), wytrzymałość 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami w kolorze zielonym.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 84

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w w/w pakiecie 18 **próbki niesterylnej**?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje dostarczenia 1 niedopłatanej próbki asortymentu będącego przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie różnych rozmiarów, dla Zamawiającego wystarczającym będzie dostarczenie dowolnie wybranego rozmiaru oferowanego przedmiotu zamówienia. **Dostarczone próbki mogą być produktem niesterylnym.**

Pytanie nr 85

Dotyczy Pakietu nr 21, poz. 5:

Czy Zamawiający wydzieli poz. 5 z w/w pakietu i dopuści siatkę kompozytową, wewnątrztrzewnową, miękką, niewchłaniającą, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylen (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała, o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m², z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, z oznaczeniem strony implantacji, dwukierunkowa elastyczność, w rozmiarze 14x18 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu pozycji, o której mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 86

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w w/w pakiecie 21, poz. 5 **próbki niesterylnej?**

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje dostarczenia 1 niedopłatanej próbki asortymentu będącego przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie różnych rozmiarów, dla Zamawiającego wystarczającym będzie dostarczenie dowolnie wybranego rozmiaru oferowanego przedmiotu zamówienia. **Dostarczone próbki mogą być produktem niesterylnym.**

Pytanie nr 87

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności faktur na 60 dni?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ustalonego na 30 dni terminu płatności faktur.

Pytanie nr 88

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zastrzeżenia, że minimalna wartość zamówienia składanego przez Zamawiającego wyniesie 150 zł?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie zaproponowanym w zapytaniu.

Pytanie nr 89

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie maksymalnej wartości kar umownych do 20% wartości umowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie zaproponowanym w zapytaniu.

Pytanie nr 90

Czy ze względu na wysoką wartość wymaganych próbek, Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie w pakiecie 21: 1 szt. próbki siatki ultralekkiej (poz. 1-5, rozmiar do wyboru Zamawiającego), 1 szt. próbki siatki przepuklinowej do zabiegów laparoskopowych (poz. 5) oraz 1 sztuki siatki do zaopatrywania przepuklin pępkowych (poz 6-7, rozmiar do wyboru Zamawiającego)?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje dostarczenia 1 niedopłatanej próbki asortymentu będącego przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie różnych rozmiarów, dla Zamawiającego wystarczającym będzie dostarczenie dowolnie wybranego rozmiaru oferowanego przedmiotu zamówienia. **Dostarczone próbki mogą być produktem niesterylnym.**

Pytanie nr 91

Czy Zamawiający w pakiecie 20 dopuści:

Poz. 1 płytką stomijną convex, dla stomii płaskiej i wklęsłej, z pierścieniem zatraskowym, płytką nie uciska na powłoki brzuszne, przylepiec hydrokoloidowy, pochłaniającą wilgoć i zabezpieczającą przed podrażnieniami skóry, rozmiar pierścienia 60 mm z docięciem 15-43 mm

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 92

Czy Zamawiający w pakiecie 20 dopuści:

Poz. 2 płytką stomijną convex, dla stomii płaskiej i wklęsłej, z pierścieniem zatrzaskowym, płytką nie uciska na powłoki brzuszne, przylepiec hydrokoloidowy, pochłaniającą wilgoć i zabezpieczającą przed podrażnieniami skóry, rozmiar pierścienia 70 mm z docięciem 15-53 mm

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 93

Czy Zamawiający w pakiecie 20 dopuści:

Poz. 3 worek ileostomijny, otwarty, przezroczysty, rozmiar 60 mm, kompatybilny z płytką w tym samym rozmiarze, z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca, umieszczonym w górnej części worka, worek o symetrycznym kształcie, z miękkimi krawędziami, zbudowany z nieprzepuszczalnego materiału, ujęcie zamykane na rzep, zakończone elastycznym plastikiem ułatwiającym utrzymanie higieny, z możliwością schowania w kieszonkę

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 94

Czy Zamawiający w pakiecie 20 dopuści:

Poz. 4 worek ileostomijny, otwarty, przezroczysty, rozmiar 70 mm, kompatybilny z płytką w tym samym rozmiarze, z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca, umieszczonym w górnej części worka, worek o symetrycznym kształcie, z miękkimi krawędziami, zbudowany z nieprzepuszczalnego materiału, ujęcie zamykane na rzep, zakończone elastycznym plastikiem ułatwiającym utrzymanie higieny, z możliwością schowania w kieszonkę

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 95

Czy Zamawiający w pakiecie 20 dopuści:

Poz. 5 worek ileostomijny, otwarty, przezroczysty, z przylepcem hydrokoloidowym pochłaniającym wilgoć oraz zabezpieczający przed podrażnieniami skóry, z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca, umieszczonym w górnej części worka, worek o symetrycznym kształcie, z miękkimi krawędziami, zbudowany z nieprzepuszczalnego materiału, ujęcie zamykane na rzep, zakończone elastycznym plastikiem ułatwiającym utrzymanie higieny, z możliwością schowania w kieszonkę, docięcie przylepca 10-76 mm

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 96

Czy Zamawiający w pakiecie 20 dopuści:

Poz. 6 worek stomijny pooperacyjny, dla stomii o zwiększonym wydzielaniu, docięcie płytki 10-100 mm, duży, jednoczęściowy, przezroczysty, z hydrokoloidowym przylepcem, elastycznym, worek o prostym, symetrycznym kształcie, zbudowany z nieprzepuszczalnego materiału, ujęcie zamykane na miękkiej kurek, z kieszonką do schowania, pojemność 725 ml

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 97

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (dotyczy pakietów 19 i 20 – worki stomijne pakowane po 30 szt, płytki po 5 szt, worki

pooperacyjne po 5 szt.)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dostawy przedmiotu zamówienia w opakowaniach, o których mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 98

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towaru i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy) – co powinno się zbiec z terminem dostawy. Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury (format pdf) na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego. Czy Zamawiający akceptuje?

Odpowiedź

Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego potwierdzający faktyczną ilość dostarczonego przedmiotu zamówienia. Faktury mogą być wystawiane i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). Ponadto Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.

Pytanie nr 99

Pakiet 11, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści worek do moczu z przednią ścianką przezroczystą, a tylną białą umożliwiającą dokładniejszą identyfikację moczu?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 100

Pakiet 14, pozycja 1-3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by rurki były silikonowane?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 101

Pakiet 14, pozycja 12

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewnik pokryty był srebrem?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 102

Pakiet 14, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych w rozmiarach CH12 i CH14 o długości 50cm, reszta parametrów zgodnie z swz?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 103

Pakiet 14, pozycja 19-20

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma otworami naprzemianległe?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 104

Pakiet 14, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 200 lub 300cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o długości 300 cm, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 105

Pakiet 14, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową Guedel o rozmiarze 3/90 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 106

Pakiet 14, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową Guedel o rozmiarze 4/100 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 107

Pakiet 14, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową Guedel o rozmiarze 5/110 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 108

Pakiet 14, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści dren Kehra w rozmiarze 45cm x 18cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 109

Pakiet 14 pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne o nacięciu skośnym długim?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 110

Pakiet 14, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi o komorze kroplowe o pojemności 21ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 111

Pakiet 14, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkuliny z igłą 0,45 x 13 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 112

Pakiet 14, pozycja 40-41

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę j.u 50/60ml skalowaną jednostronnie?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 113

Pakiet 14, pozycja 45

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 150cm spełniający pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 114

Pakiet 14, pozycja 46

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 115

Pakiet 14, pozycja 52

Czy Zamawiający dopuści dren do jamy otrzewnowej CH27 lub CH30 o długości 50cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 116

Pakiet 14, pozycja 53

Czy Zamawiający dopuści dren do jamy otrzewnowej CH33 o długości 50cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 117**Pakiet 14, pozycja 54**

Czy Zamawiający dopuści automatyczny jednorazowy nakłuwacz igłowy o średnicy 0,6mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 118**Pakiet 14, pozycja 62**

Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania leków 1,2x30mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 119

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12, poz. 3 dopuści jako równoważny obwód oddechowy o standardowej długości 180cm, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o którym mowa w zapytaniu, jako przedmiotu równoważnego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 120- dot. pakietu nr 12 poz. 4

Prosimy o doprecyzowanie, gdyż nie istnieje na rynku obwód oddechowy rozciągliwy o regulowanej długości, z łącznikiem Y i do tego współosiowy. Opis jest jakby połączeniem dwóch różnych obwodów. Obwody rozciągliwe posiadają łącznik Y, obwody współosiowe nie posiadają łącznika Y. Jeżeli Zamawiający wymaga obwodu rozciągliwego, prosimy o wykreślenie słowa „współosiowy”, gdyż cały opis wskazuje właśnie iż ma to być obwód rozciągliwy, a nie współosiowy. Wobec tego: Czy Zamawiający ma na myśli obwód rozciągliwy, jednorazowego użytku, o średnicy 22 mm, składający się z:

- 2 rury o regulowanej długości min. 150 cm

- dodatkowa rura o regulowanej długości min. 150 cm z workiem 2 l do aparatów do znieczuleń

- łącznik Y zintegrowany z rurami,
- twarde zakończenie do strony aparatu
- mikrobiologicznie czysty
- z możliwością stosowania min. 48 godzin ?

Czy Zamawiający ma na myśli obwód współosiowy, jednorazowego użytku, składający się z:

- 1 rury współosiowej dł. min. 150 cm, z gałęzią wdechową rozciągliwą do min. 40 cm
- dodatkowa rura o regulowanej długości min. 150 cm z workiem 2 l do aparatów do znieczuleń
- twarde zakończenie do strony aparatu
- mikrobiologicznie czysty
- z możliwością stosowania min. 48 godzin ?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że oczekuje zaoferowania obwodu rozciągliwego, jednorazowego użytku, z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 121- Odnosnie Pakietu nr 11 w poz. 1

„Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych, o których mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 122

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr. 11 poz. 1?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu pozycji, o której mowa w zapytaniu.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla Wykonawców i przygotowując ofertę przetargową należy brać pod uwagę wszelkie powyższe ustalenia.

Zatwierdzam:

Z up. Dyrektora Szpitala

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

Anna Kubicka